



手洗いは感染対策の基本！


「洗った？」それとも「洗えた？」

洗ったつもりでも、まだ目に見えない汚れが残っているかもしれません。ルミテスターならきちんと「洗えた」かどうか、数値で確認することができます。

専用アプリ『Lumitester』を活用すれば数値の管理も簡単です。正しい手洗いの教育ツールとしてもお役立てください。



- 1、ATPふき取り検査（A3法）とは？
- 2、ATPふき取り検査（A3法）の必要性
- 3、測定原理
- 4、検査に必要な測定器と測定キット
- 5、検査箇所、管理基準値、ふき取り方法
- 6、使用上の注意点
- 7、ルミテスター活用事例
- 8、専用アプリ『Lumitester』

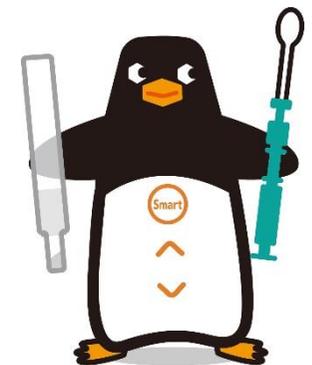


1、ATPふき取り検査（A3法）とは？

生物に含まれる3つの物質を指標にした清浄度検査

ATP (アデノシン三リン酸)

ADP (アデノシン二リン酸)

AMP (アデノシン一リン酸)

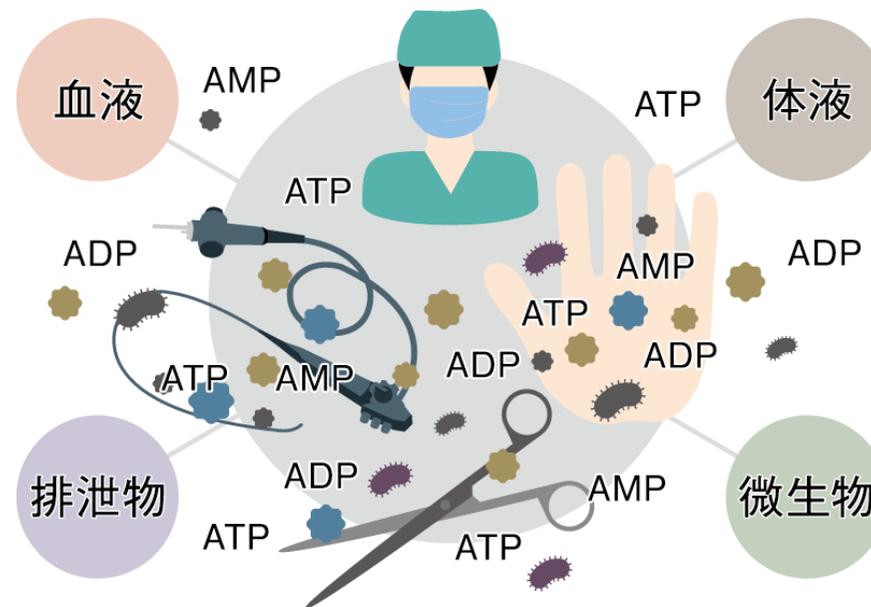

ATP、ADP、AMPが存在するという事は、そこに生物あるいは生物の痕跡が存在する証拠です。

生物あるいは生物の痕跡の存在ということは、

血液、体液、排泄物などの**ヒト由来の汚れが存在する**ということです。

汚れが存在すればそれは菌の餌となり、そこは菌が増殖するための環境になっているともいえます。

1、ATPふき取り検査（A3法）とは？

ATP+ADP+AMP量で洗浄・清拭の評価ができます



洗浄前

ATP+ADP+AMP量が多い

- ▶ 汚れも微生物も多い
- ▶ 洗浄不足と判定



洗浄後

ATP+ADP+AMP量が少ない

- ▶ 汚れが少なければ
微生物も除去される



ATPふき取り検査（A3法）は、洗浄・清拭がきちんと行われたかがわかります。ウイルスや病原性微生物は環境表面で一定の期間生存することが知られています。しっかり洗浄・清拭すれば、環境表面の汚れを除去することができるので、感染リスクの低減にもつながります。

2、ATPふき取り検査（A3法）の必要性




ATPふき取り検査（A3法）は、
汚れも微生物も両方測定できる検査法。
でも、微生物だけの存在がわからないなら、
検査する意味があるの？



2、ATPふき取り検査（A3法）の必要性

手洗い前後での微生物、汚れの挙動のイメージ

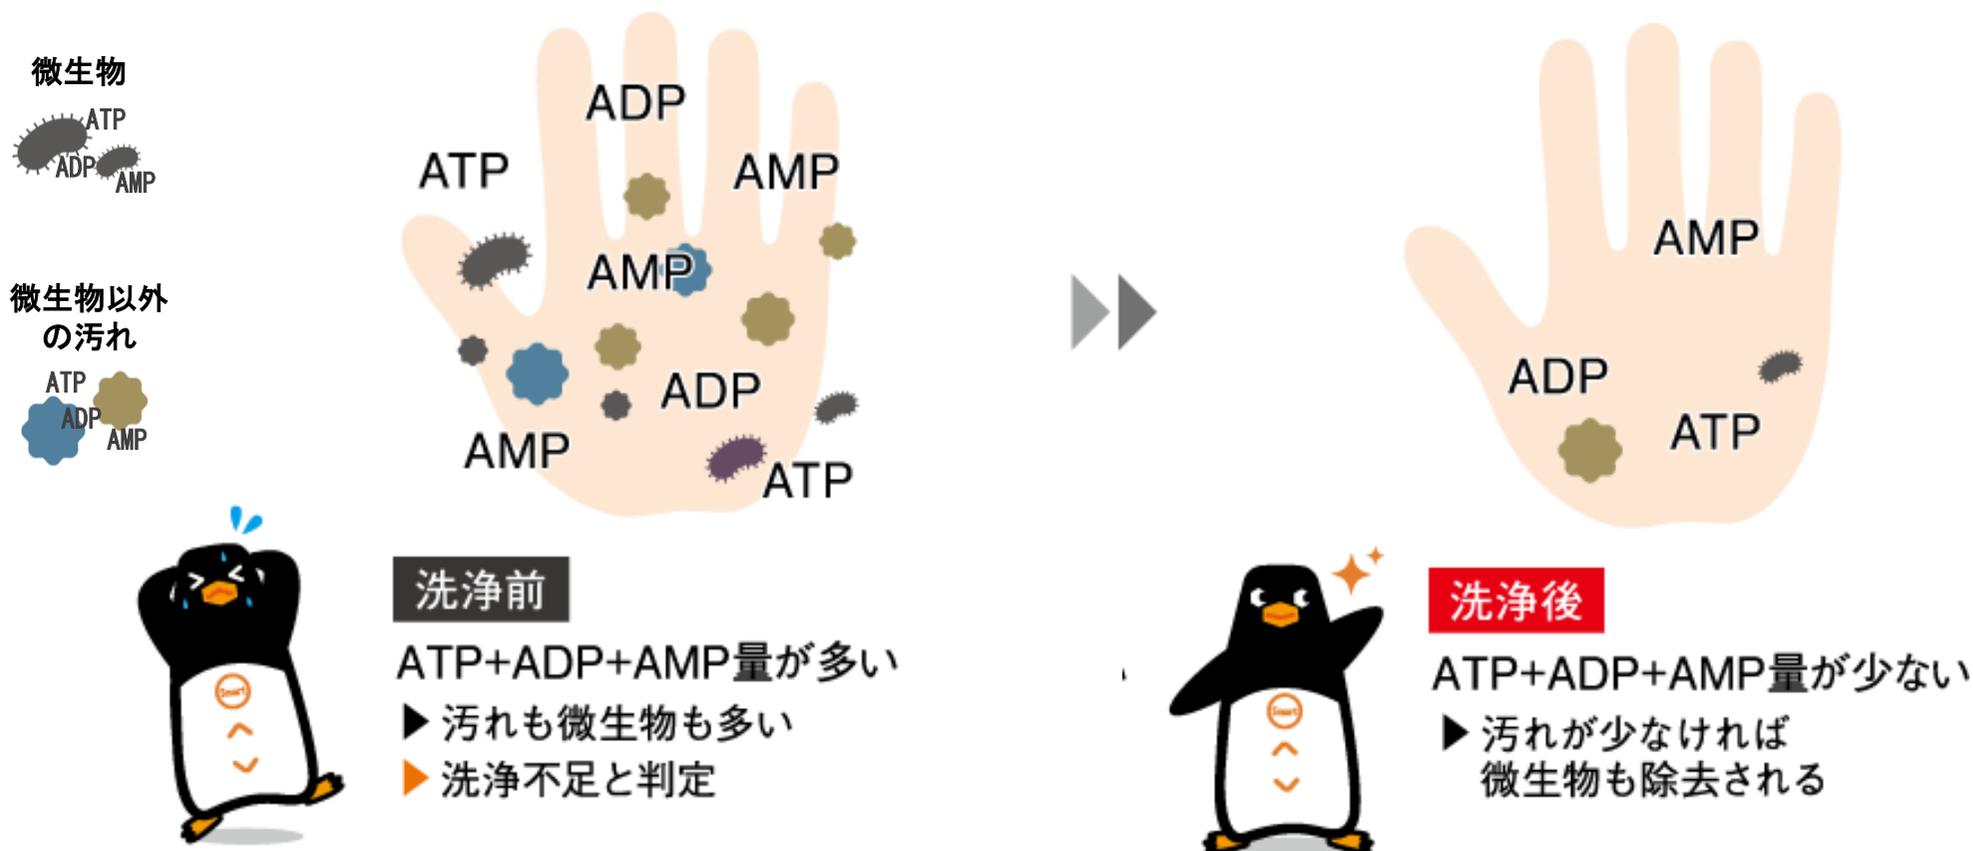

手洗いがきちんとなされれば、微生物も汚れも除去されます。
ATPふき取り検査（A3法）は微生物のみを検出する方法ではありませんが、
ATP+ADP+AMP量が少なくなっていれば、微生物量も少なくなっていることがわかります。


2、ATPふき取り検査（A3法）の必要性



ATPふき取り検査（A3法）は、微生物量を直接的に測定するものではありませんが、ATP+ADP+AMP量を測定すれば、手洗いがきちんと行われたか＝微生物量を少なくできたかの目安になります。



ホタルルシフェラーゼによる測定

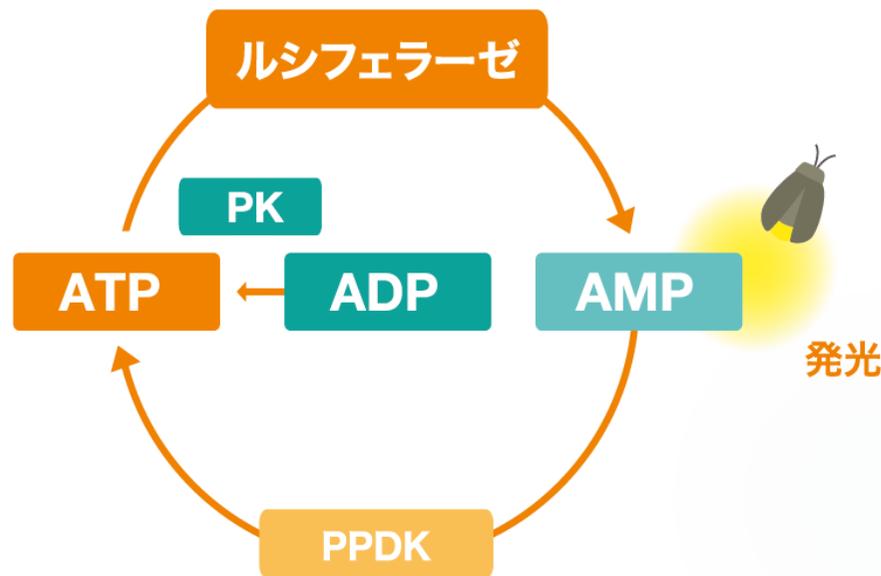

ATP, ADP, AMP全ての測定を可能にした
キッコーマンのATPサイクリング反応

ATP再生酵素

PK : ADPをATPに変える酵素
PPDK : AMPをATPに変える酵素

ルシフェラーゼ

ATPから光を生み出す酵素

汚れの中にあるATPを、ホタルの発光反応を用いて測定しています。

ホタルルシフェラーゼにより、ATPがAMPに変換される際に生じる光の強さでATP量が測定できます。


さらに、ルシフェラーゼとPK、PPDKと組み合わせることにより、ATP、ADP、AMPを同時に測定することが可能になりました。

4、検査に必要な測定器と測定キット

ルミテスター Smart (測定器)




ルシパック A3 Surface (専用試薬)

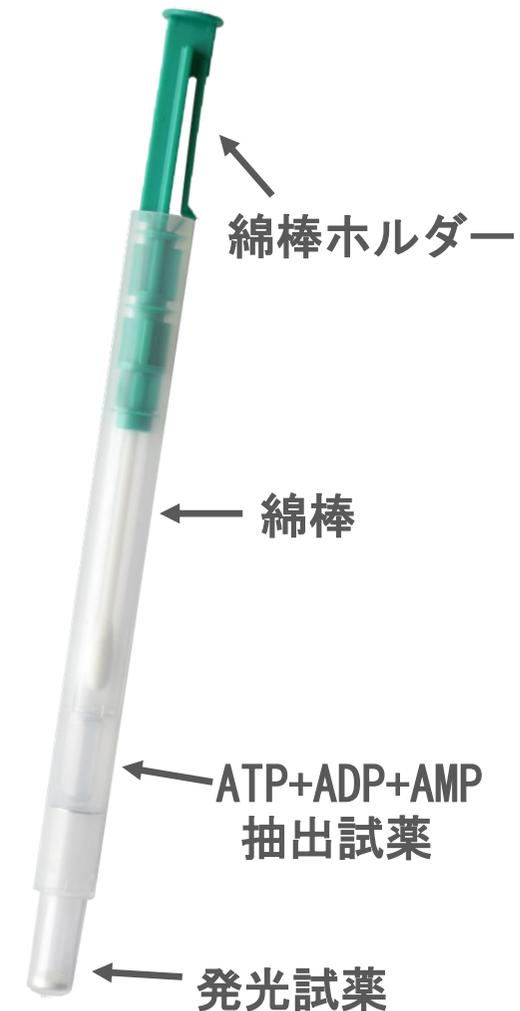


5、管理基準値、ふき取り方法

石鹼と流水で手洗いしたあとに検査します


手の平を縦に5往復ふく

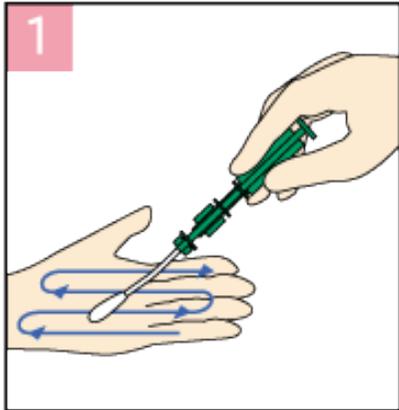


手の平を横に5往復ふく

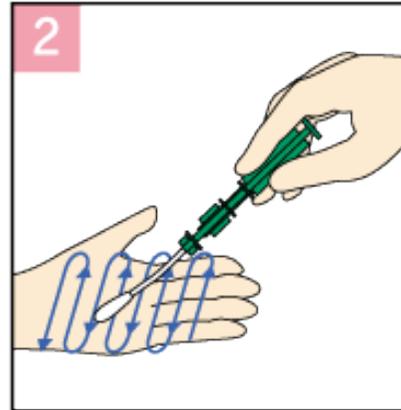

指の間をふく

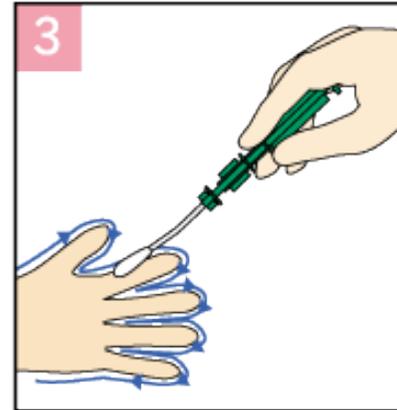

指先をふく

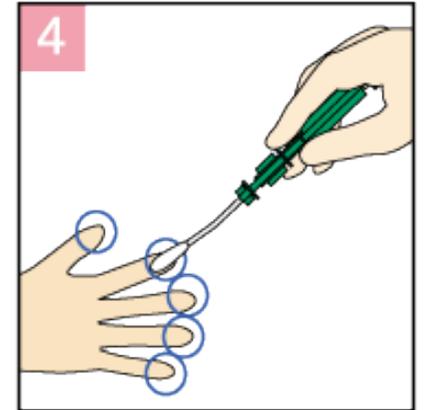

手洗い後の管理基準値は「2,000RLU以下」を推奨しています。


※ご注意！

擦式アルコール剤の殺菌効果は検証できません。

(ATPふき取り検査(A3法)は菌検査ではありません)

基本的なふき取り方法

ルシパック A3 Surfaceの保管は、冷蔵庫(2°C~8°C)でお願いします。

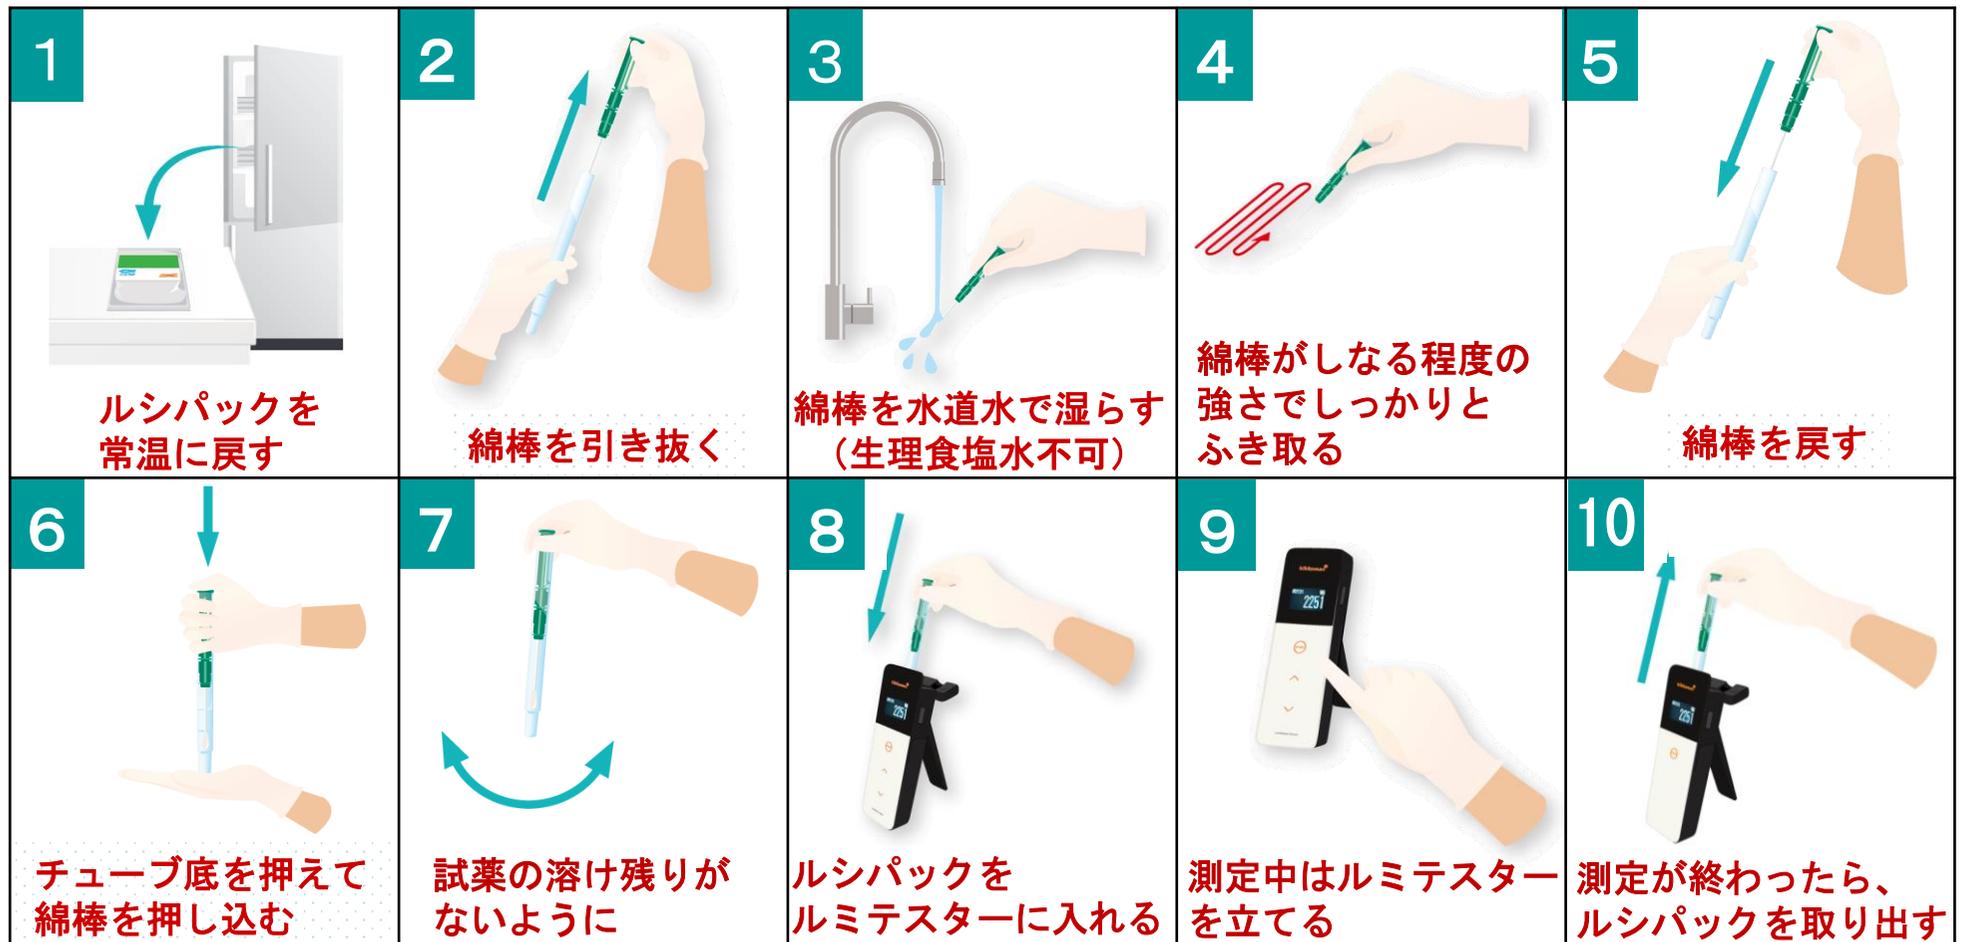

6、使用上の注意点

ルシパックの保管と使用温度


保管：冷蔵庫

2 ~ 8 °C




品質保持期限

製造後15ヶ月迄

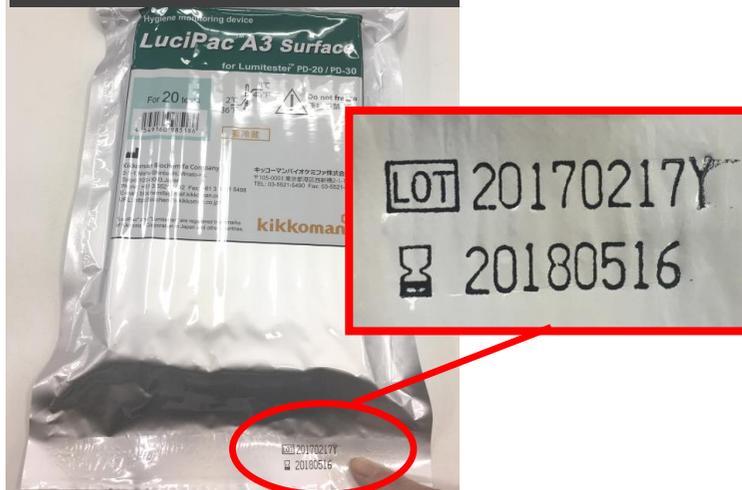

使用：室温

20 ~ 35 °C

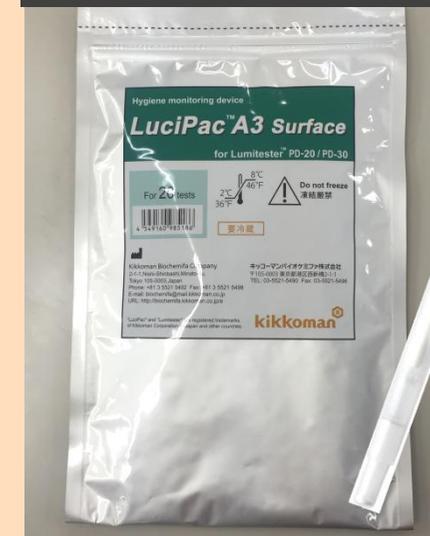

室温に戻してから使用します
(約20分間で室温に戻ります)
開封後は2週間以内にご使用ください

未開封常温放置の使用期間

25°C以下 : 14日間
30°C以下 : 5日間

6、使用上の注意点

夏場はルシパックの取り扱いに注意が必要

車で運搬される際には保冷剤をご利用ください



ルミテスターは冷蔵しないでください





結露による故障の原因となります

綿棒の角度と幅

ふき取り幅

≒ 5mm

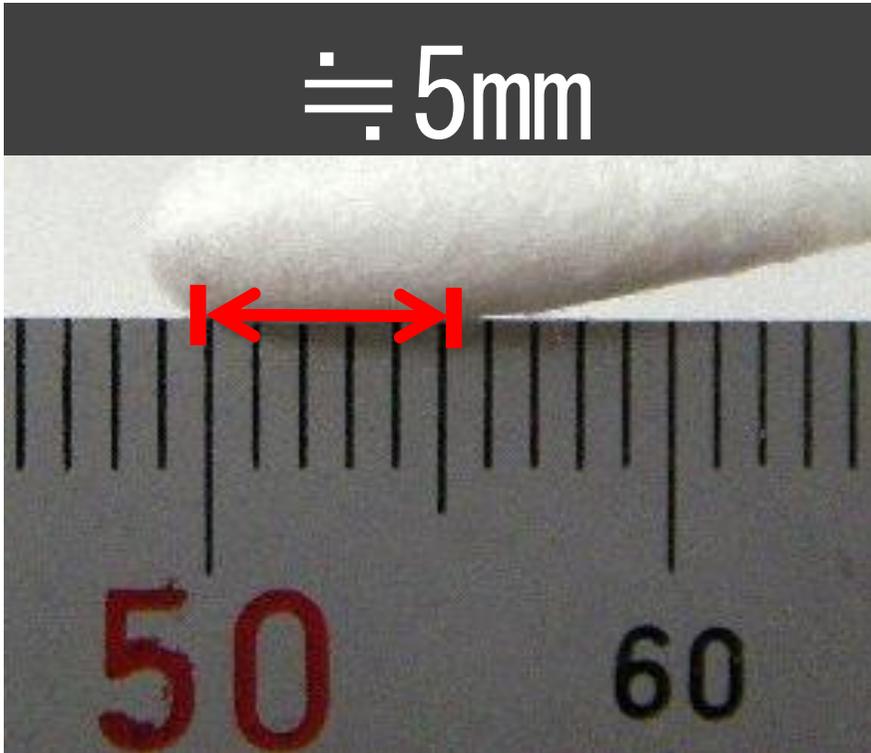


ふき取り角度

10~20度





6、使用上の注意点

ふき取る強さ（綿棒が軽くしなる程度に）

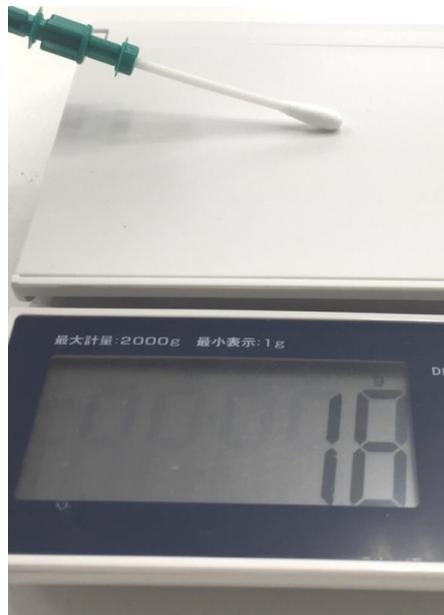

弱すぎる

先端だけでふき取らないように

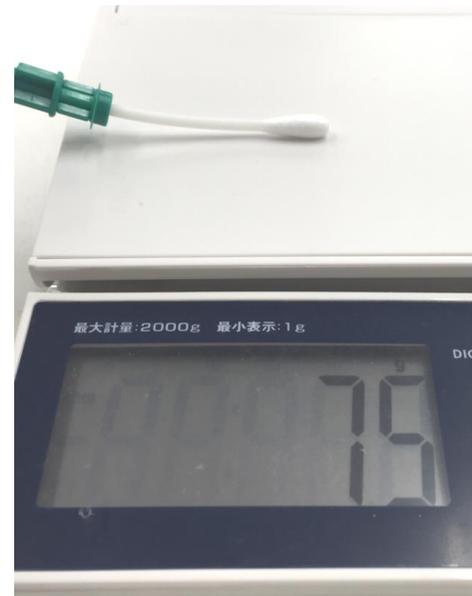


OK

綿球表面全体が 検査箇所にし
っかり付着するように

6、使用上の注意点

ふき取り回数（縦横10往復、隙間なくふき取る）

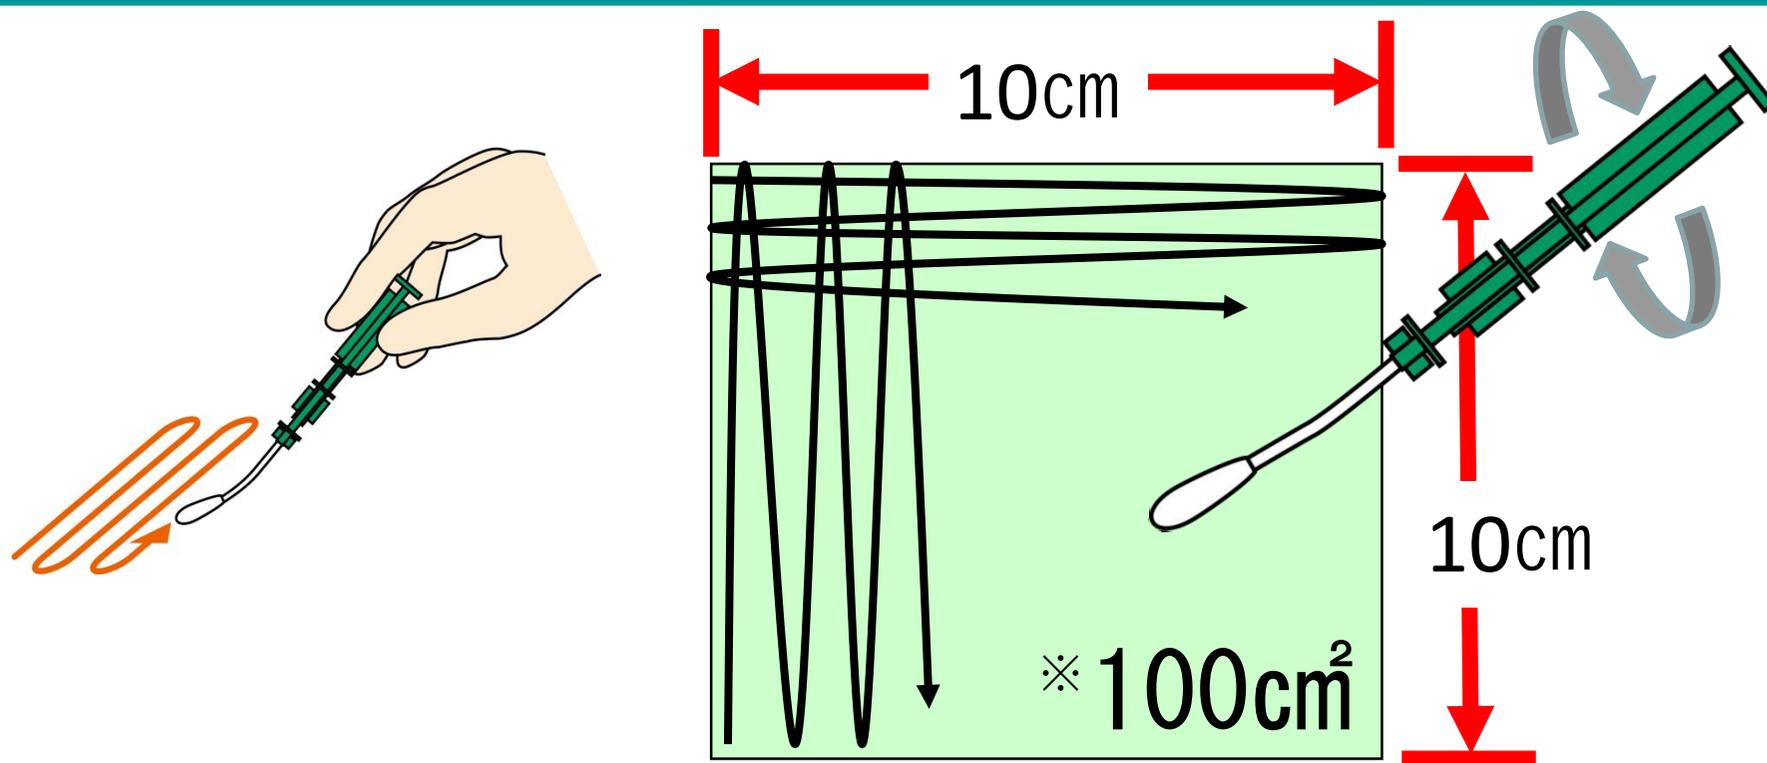


綿棒は回転させながら、30秒程度の時間をかけてふき取る

※10cm×10cmのふき取り面がとれない場合は、ふき取り面積の合計が100cm²になるように、もしくは、なるべく100cm²となるようにふき取ってください。

6、使用上の注意点

試薬はしっかり溶かす（溶け残りがないように）



発光試薬を溶かし終えたらすぐに測定へ

測定中はルミテスターを立てる



スタンド利用

測定中ルミテスターを横にすると正しく測定できません

6、使用上の注意点

試薬の反応を阻害する物質

食塩		エタノール		次亜塩素酸ナトリウム		オスバン (塩化ベンザルニウム10%)	
濃度 (%)	発光率 (%)	濃度 (%)	発光率 (%)	有効塩素 濃度(ppm)	発光率 (%)	濃度 (%)	発光率 (%)
0	100.0	0	100.0	0	100.0	0	100.0
0.1	90.2	1.0	95.7	20	103.4	0.01	96.7
0.2	77.7	2.0	99.6	50	99.8	0.05	95.6
0.5	62.3	5.0	89.2	100	96.9	0.1	98.2
1.0	43.3	10.0	80.1	200	91.9	0.5	76.7
2.0	27.4	20.0	65.0	500	73.2	1.0	64.6
-	-	50.0	32.4	1000	38.0	-	-

※阻害物質0%の時に発光率100%として測定
(綿球にAMPを添加した各液0.1ml滴下時の発光率)

低値になってしまう原因として考えられること

ルシパック(試薬)の反応を阻害する物質がある

ルミテスターを横にして測定している

ルシパックの発光試薬が溶け残っている（または抽出試薬を落とし切れていない）

ルシパックを20度未満で測定している（温度が低ければ低いほど低値になります）

ふき取りがしっかりとされていない

ルシパックが適切に保管されておらず、劣化している

活用事例


↑ ↑ ↑
活用事例はこちらをクリック
してご覧ください

川崎市立多摩病院

国立研究開発法人
国立国際医療研究センター

日本歯科大学
東京短期大学

防衛医科大学校
防衛医学研究センター

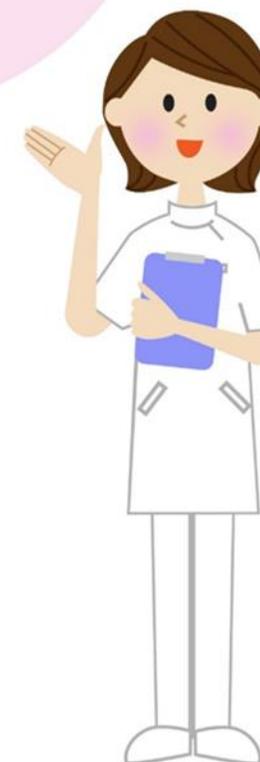

8、専用アプリ『Lumitester』



データの記録・管理には、
専用アプリ『Lumitester』が便利です。



8、専用アプリ『Lumitester』

検査結果をより有効に活用いただくために

- ✓ スマートフォン・タブレット・PCと連動
- ✓ 専用アプリでデータを簡単に管理
- ✓ クラウドと連携し、データを共有

ルミテスター
Smart
なら使い方は
カンタン!

数値測定・記録



専用アプリとの連動で、測定値を自動で管理!面倒な手書き、PC入力が必要に!

指導・改善



アプリで測定値の分析を手早く自動作成できるので、その場での指導・改善が可能に!

履歴・管理



測定データはアプリに蓄積され、検査ポイントごとの測定結果トレンドグラフや施設全体の合格率を自動作成。履歴管理がアプリで簡単に!

ルミテスターSmartとの連動イメージ

① Bluetoothでスマートフォン・タブレットに接続



② 検査ポイントを選んで測定



③ 検査ポイント毎に測定結果を保存



④ 測定データを蓄積、自動でグラフ化



8、専用アプリ『Lumitester』

専用アプリ『Lumitester』は無料



- ← 専用アプリ『Lumitester』については、
- ← 弊社ホームページをご参照ください。
- ← <https://biochemifa.kikkoman.co.jp/support/dl/smart/>



— スマートフォン・タブレットでご利用の方はこちら

Android版

iOS版



操作説明はこちらを
ご参照ください →

[アプリ操作説明書](#)

[スマホ用\(PDF\)⇒⇒](#)

[タブレット用\(PDF\)⇒⇒](#)

— パソコンでご利用の方はこちら

パソコン向け(Windows版)

[Windows版アプリ](#)

以上

